




POLARIC™-500c6F

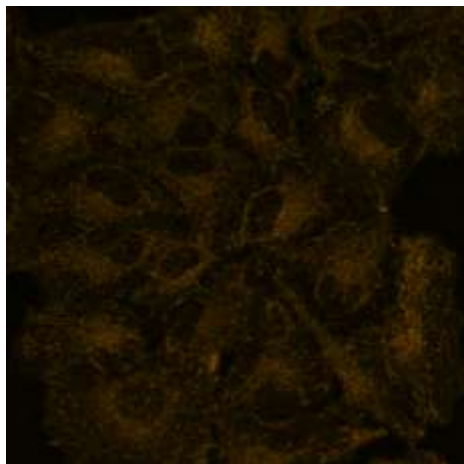


0hr

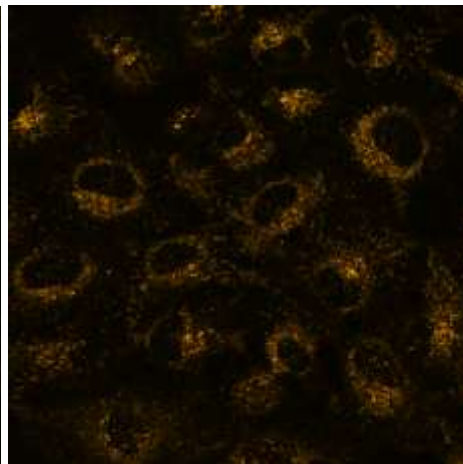


12hrs

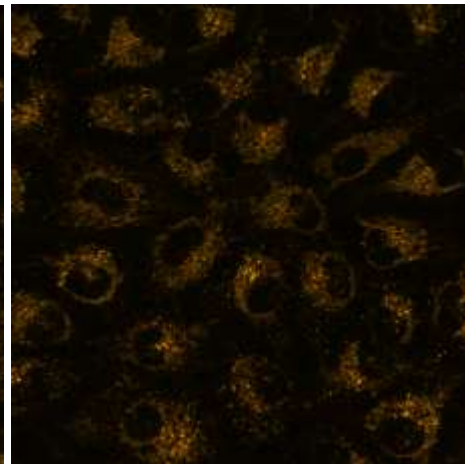


24hrs

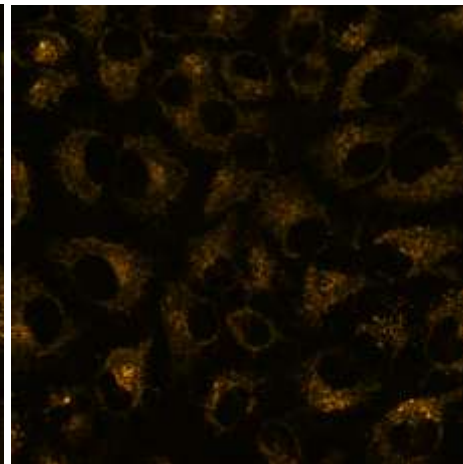


36hrs

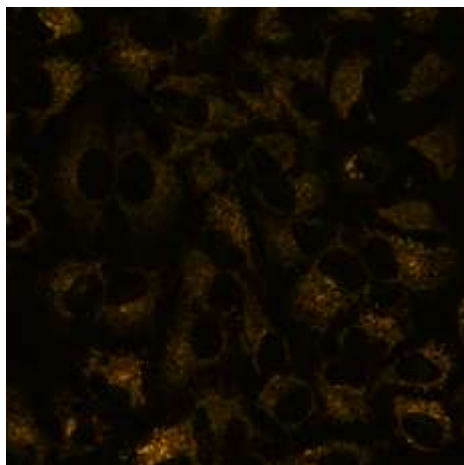


48hr

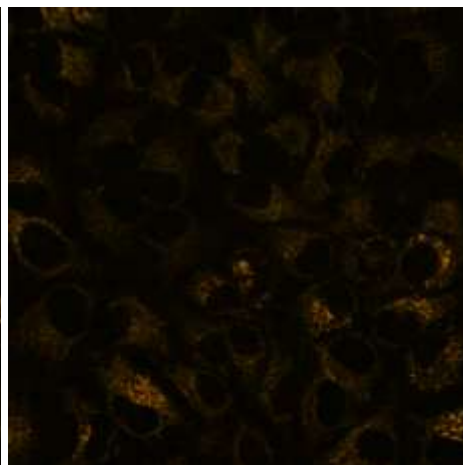

60hrs

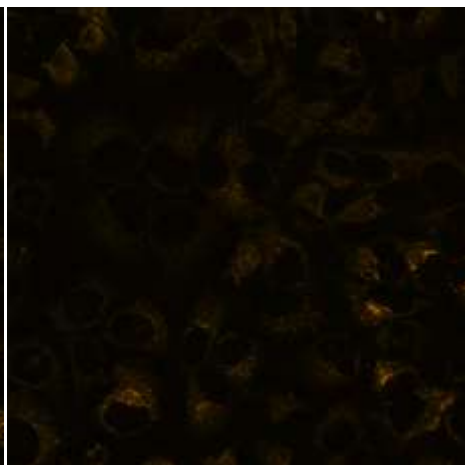


72hrs

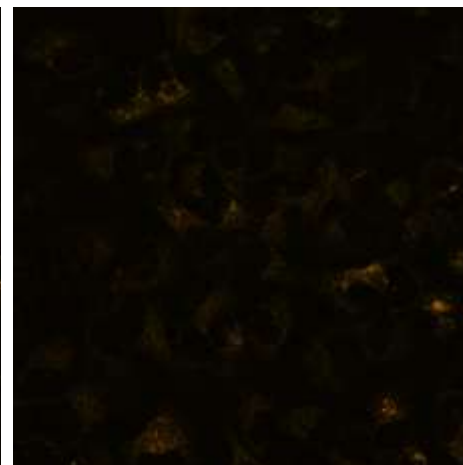


84hrs


MitoTracker® Green

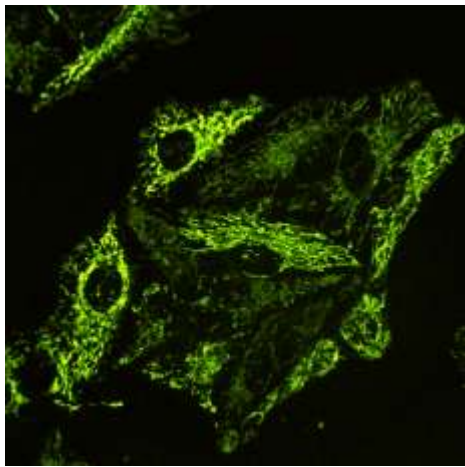


0hr

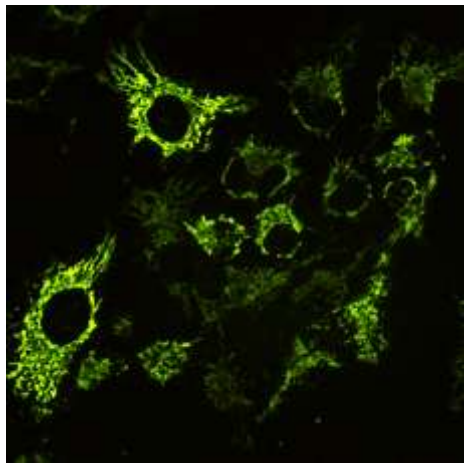


12hrs

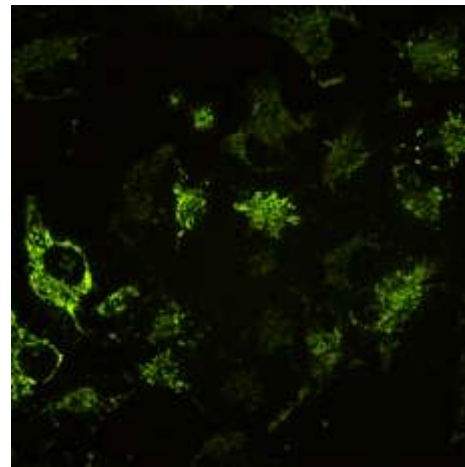


24hrs

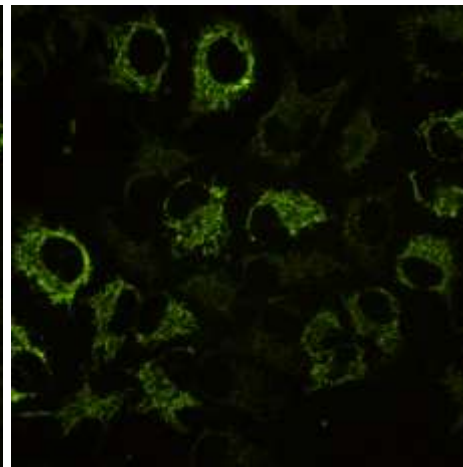


36hrs

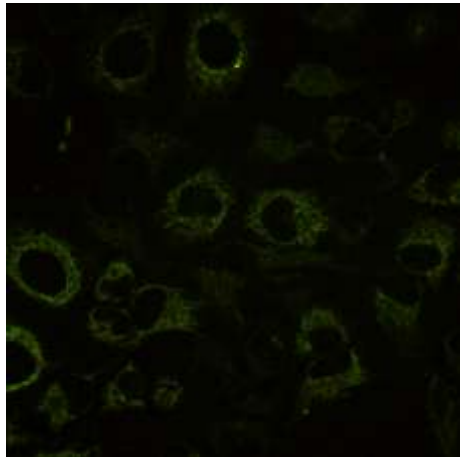


48hr

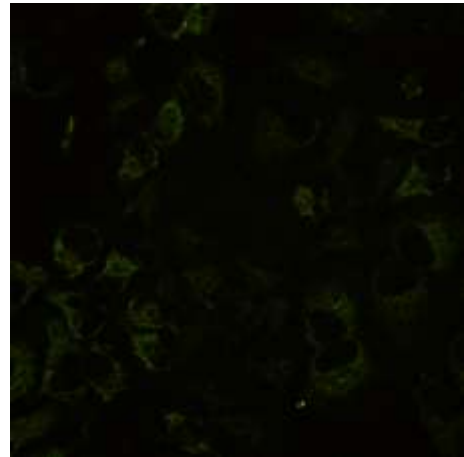

60hrs

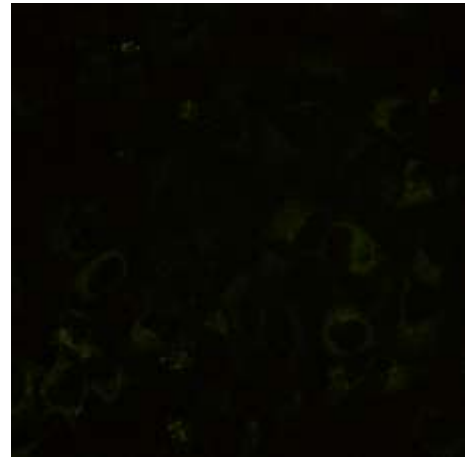

72hrs

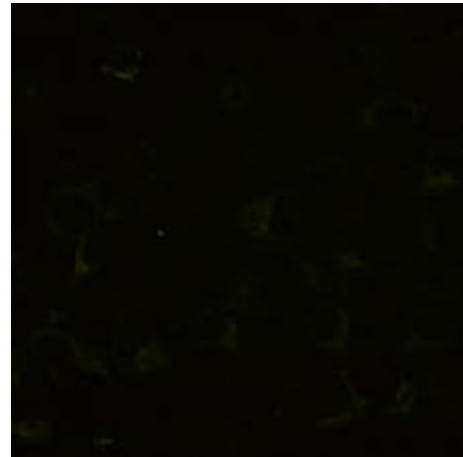

84hrs

観察48時間から、POLARIC™-500c6FとMitoTracker®Greenとの保持性の差が顕著であった。